



Kittos City

Cadeira de rodas eléctrica dobrável

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. SEPALCITY

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE **OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.**

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com a sua nova cadeira de rodas elétrica **Kittos City**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

| | |
|---|-----------|
| 1 – Partes | 4 |
| 2 – Descrição | 4 |
| 3 – Medidas | 5 |
| 4 – Características técnicas | 5 |
| 5 – Prefácio | 6 |
| 6 – Desempenho do produto | 6 |
| 7 – Instruções de segurança | 7 |
| 8 – Ajuste da cadeira de rodas | 8 |
| 9 – Bateria e carregador | 10 |
| 10 – Sistema de diagnóstico | 11 |
| 11 – Controlador | 12 |
| 12 – Manutenção | 13 |
| 13 – Garantia | 14 |

1. PARTES



2. DESCRIÇÃO

É uma cadeira ideal para viagens e uso urbano, dobra-se em apenas 5 segundos e tem rodas patenteadas para facilitar o transporte quando dobrado. Tem novas melhorias, tais como um novo sistema de extracção de bateria melhorado, um novo sistema de fácil ligação e desconexão do motor. A Kittos City tem uma largura total de 59,8 cm.

A cadeira de rodas Kittos City tem diferentes opções de bateria, 20 Ah, 30 Ah e 40 Ah, esta última oferecendo um alcance de 40 a 45 km, permitindo a liberdade de movimento. Com esta vantagem de autonomia, o utilizador pode viajar com conforto e tranquilidade as distâncias habituais numa cidade. Graças ao seu tamanho estreito e compacto, a Cidade Kittos, com uma

profundidade de 80 cm, uma largura total de 59,8 cm e uma altura total de 99 a 109 cm, pode facilmente negociar espaços apertados, tais como portas e elevadores. As rodas dianteiras são sólidas com um diâmetro de 20cm e as rodas traseiras são também sólidas com um diâmetro de 32cm.

A cadeira eléctrica Kittos City vem com um encosto regulável em altura, de 99 a 109 cm de altura total. O assento mede 45 cm de largura por 44 cm de profundidade e a distância entre o assento e o chão é de 48 cm. Tem dois motores de 180W e uma bateria de 20Ah, 30Ah ou 40Ah. Tem travões electromecânicos e um carregador externo de 5W. Com este motor atinge uma velocidade máxima de 7 km/h.

3. MEDIDAS



MEDIDAS

- 1 Altura total: 99 - 109 cm
- 2 Profundidade total sem apoio para os pés: 80 cm
Profundidade total: 102 cm
- 3 Largura total: 59 cm
- 4 Altura do assento ao chão com almofada: 53 cm
Altura do assento ao chão sem almofada: 48 cm

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Peso | |
|---------------------------------|----------|
| Peso total sem baterias | 29,30 kg |
| Peso total com bateria de 20 Ah | 31,90 kg |
| Peso total com bateria de 30 Ah | 32,95 kg |
| Peso total com bateria de 40 Ah | 34 kg |
| Peso máximo suportado | 120 kg |

| | |
|----------|----------|
| Material | Alumínio |
|----------|----------|

| | |
|-----|--------------|
| Cor | Cinzeno mate |
|-----|--------------|

| Assento | |
|-------------------------|------------------------|
| Largura do assento | 45 cm |
| Profundidade do assento | 44 cm |
| Tipo de assento | Acolchoamento / Espuma |

| Motor | |
|--------------------|--|
| Potência do motor | 24V 180W |
| Bateria | 20 Ah / 30 Ah / 40 Ah |
| Número de baterias | 1 |
| Autonomia | 20-25 km (20Ah) / 30-35km (30Ah) / 40-45km (40 Ah) |
| Velocidade máxima | 7 km/h |
| Carregador externo | 5Ah |

| Encosto | |
|---------------------|-------------------------|
| Largura do encosto | 39 cm |
| Altura do encosto | 55 cm |
| Tipo de encosto | Altura ajustável |
| Material de encosto | Acolchoado com tensores |

| Apoios de braços | |
|-------------------------------|-----------|
| Comprimento do braço de apoio | 32 cm |
| Largura do apoio de braço | 5 cm |
| Tipo de apoio de braço | Dobradura |
| Material de apoio ao braço | Injectado |

| Apoio para os pés | |
|-------------------------------|---------------------|
| Tipo de apoio para os pés | Plataforma dobrável |
| Material do apoio para os pés | Plástico e alumínio |

| Rodas | |
|------------------------------|---------|
| Medidas da roda dianteira | Ø20 cm |
| Medidas da roda traseira | Ø32 cm |
| Largura das rodas dianteiras | 4,7 cm |
| Largura da roda traseira | 4,8 cm |
| Tipo de rodas | Maciços |

| Outras características | |
|--------------------------|--------------------------|
| Cinto de segurança | Sim |
| Trompa | Sim |
| Travões | Travões electromecânicos |
| Luzes frontais | Não (Lightcare opcional) |
| Luzes traseiras | Não (Lightcare opcional) |
| Marcha atrás | Sim |
| Inclinação máx. escalada | 10° |
| Dobradura | Sim |
| Raio de viragem | 360° |
| Rodas anti-volteio | Sim |
| Rodas de transporte | Sim |
| Suspensão | Sim |

5. PREFÁCIO

Por favor leia atentamente o manual do utilizador antes de utilizar o produto.

- Este manual contém operações, métodos de montagem e resolução de problemas simples.
- Este manual aplica-se ao nosso modelo: **Kittos City**
- Este manual contém métodos de manutenção de cadeiras de rodas e auto-ensaio, colocá-lo no local apropriado.
- Forneça este manual para referência quando outros estiverem a utilizar esta cadeira de rodas.
- As notações e ilustrações deste manual podem diferir ligeiramente das peças reais devido à melhoria da qualidade ou alteração do design.
- Contacte o seu revendedor se houver quaisquer ambiguidades ou perguntas. A utilização inadequada de qualquer veículo pode resultar em lesões. A condução insegura pode ferir-se a si próprio e aos outros.

- A cadeira de rodas elétrica foi concebida para transportar confortavelmente pessoas com dificuldades de locomoção ou sem capacidades de locomoção
- Esta cadeira de rodas elétrica está concebida para transportar apenas 1 pessoa.

Símbolos utilizados neste manual



CUIDADO

Siga as instruções junto a este símbolo.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em lesões físicas ou danos na cadeira de rodas ou no ambiente.

6. DESEMPENHO DO PRODUTO

Esta série de cadeiras de rodas elétricas é alimentada por bateria, accionada por motor. Os utilizadores controlam a direcção e ajustam a velocidade através do controlador do joystick. É adequado para baixa velocidade, boas condições de estrada e aplicações de baixo declive.

ESTRUCTURA PRINCIPALL

Esta série de cadeiras de rodas elétricas é composta principalmente por duas partes:

- 1)** Parte da estrutura: estrutura, roda, apoio para os pés, apoio para os braços, encosto, etc.
- 2)** Parte elétrica: controlador, motor, bateria.

GAMA DE APLICAÇÃO

A nossa cadeira de rodas elétrica é para pessoas com mobilidade reduzida e idosos (menos de 120 kg), é adequada para viagens de média distância ao ar livre.

7. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

7.1 INSTRUÇÕES DE CONDUÇÃO

Precauções gerais de manuseamento

- Mantenha as mãos sobre o apoio de braço para controlar a cadeira de rodas.
- Pratique em parques ou outros locais seguros e abertos até ser capaz de utilizar a cadeira de rodas com destreza.
- Praticar totalmente a condução num local seguro, parar e virar em círculos.
- Antes de conduzir na estrada, ser acompanhado por técnicos de saúde e confirmar que é seguro.
- Siga rigorosamente as regras de tráfego pedonal, não se considere o condutor do veículo.
- Conduzir no pavimento e na passagem de zebra. Não conduzir na faixa de rodagem do veículo.
- Manter correctamente a pressão dos pneus, uma pressão anormal dos pneus pode causar uma condução instável ou uma perda excessiva de potência.

Evite

- Não conduzir com mau tempo, tais como chuva, nevoeiro forte, vento forte, neve, etc.
- No caso da cadeira de rodas estar molhada, limpar imediatamente a água.
- Não conduzir em más condições de estrada, tais como lama, caminho pedonal, estrada arenosa, cascalho, etc.
- Não conduza numa estrada apinhada.
- Não conduzir em valas ou lagos, ou em vias férreas.
- A cadeira de rodas eléctrica é apenas para uso pessoal, não para transporte de pessoas ou bens, e não se destina à tracção.

Precauções para encostas

- Evite conduzir nos seguintes locais: colinas íngremes, locais íngremes, degraus altos, canais, etc.
- Evite conduzir em declives íngremes, o alcance da inclinação deve ser inferior a 10 graus. Operar cuidadosamente o controlador ao conduzir em declives.
- Continuar a subir ou a descer.
- Abrandar durante a descida.
- Evitar conduzir de lado na encosta.
- Não conduzir em escadas e evitar atravessar degraus altos.
- Evitar atravessar valas largas.
- Ao atravessar valas, manter ângulos de 90° entre pneus e valas.
- Se a cadeira de rodas não funcionar correctamente num cruzamento, pedir assistência imediatamente. Colocar a cadeira de rodas no modo manual, depois empurrar a cadeira de rodas para longe da passagem, afastar-se imediatamente do local para um local seguro.



CUIDADO

Não colocar a cadeira de rodas em modo manual durante a condução em subidas e descidas de montanha

Precauções para os prestadores de cuidados

- Assegurar que os pés dos utilizadores estão na posição correcta sobre os apoios para os pés e garantir que o vestuário não fica colado às rodas.
- O cuidador deve empurrar a cadeira de rodas para a frente para se manter seguro em declives íngremes ou inclinações longas.

7.2 OUTRO AVISO

Reparação e remodelação

Se a reparação e modificação forem necessárias, contacte o seu revendedor. Não o modifique você mesmo, pode causar acidentes ou avarias.

Proteger o ambiente

Para proteger o ambiente, não descarte casualmente a cadeira de rodas ou a bateria. Contacte o seu revendedor local para substituir a nova bateria.

- **Manter o ambiente de armazenamento seco**

Não guardar a cadeira de rodas em condições de humidade, como por exemplo perto da casa de banho. Se a cadeira de rodas se molhar com a chuva, limpe imediatamente a água.

- Não substituir peças ou material aleatório.

- Não colocar pesos aleatórios, pois isto pode causar um desequilíbrio.
- Não utilizar outro veículo para puxar ou empurrar a cadeira de rodas quando alguém estiver sentado na cadeira de rodas ou a cadeira de rodas estiver em modo manual.

Quando houver um som anormal, contactar imediatamente o serviço.


Protecção contra interferência eletromagnética

A cadeira de rodas deve estar longe de campos magnéticos fortes e de grandes equipamentos eléctricos indutivos, tais como estações de rádio, estações de televisão, estações de rádio subterrâneas, estações de rádio de transmissão de telemóveis.


8. AJUSTE DE CADEIRA DE RODAS

8.1 CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL

Passo 1: Levante a alavanca para cima, como mostra a figura 1.

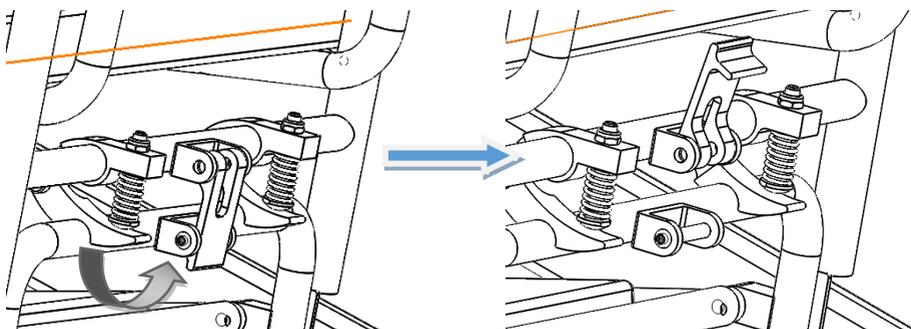


Passo 2: Comprimir o tubo de encosto como mostra a figura 2 para o dobrar completamente.

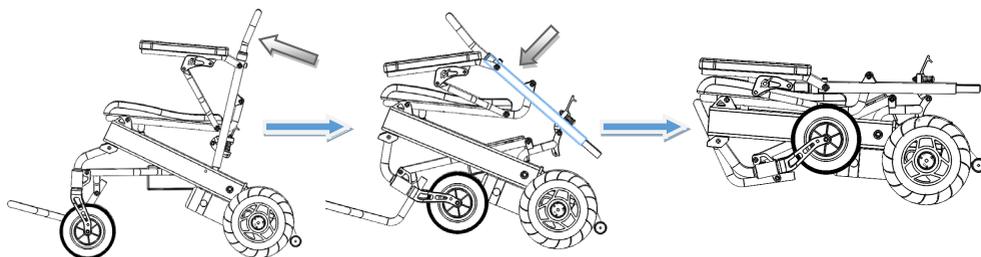


8.2 UTILIZAÇÃO DO APOIO DE BRAÇO

Passo 1: Virar o botão para cima.

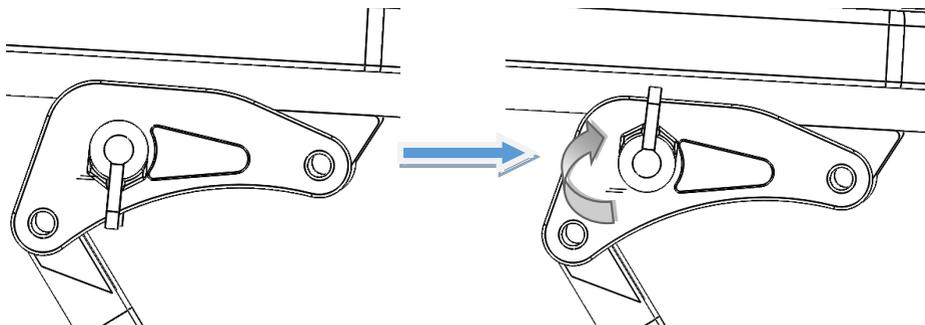

Passo 2: Levantem o braço.

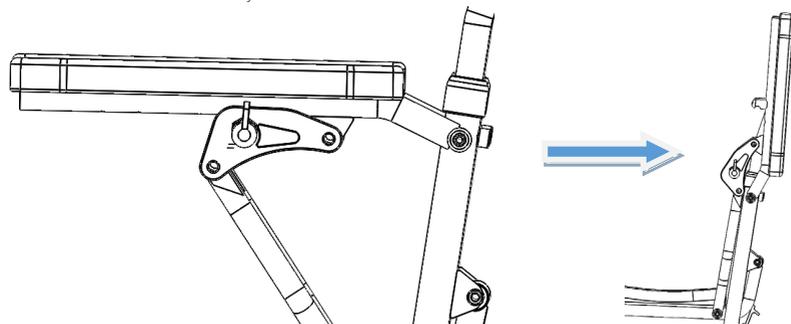

8.3 AJUSTE DO JOYSTICK - COMPRIMENTO E DOBRAGEM

1. Estender o braço de apoio

Para ajustar a profundidade do braço, desatarraxar a porca e colocá-la na posição desejada. Assim que estiver na posição perfeita, reapertar a porca. · **Figura 1**

2. Dobrar o botão de controlo

Para dobrar o botão de controlo, desatarraxar a porca 2 e dobrá-la para baixo. Uma vez no lugar, apertar novamente a porca. · **Figura 2**

Figura 1



Figura 2



9. BATERIA E CARREGADOR

9.1 BATERIA

A cadeira pode ser dobrada sem remover as baterias.

9.2 REQUISITOS DO CARREGADOR

O carregador é utilizado para carregar a bateria. Ao carregar a cadeira de rodas elétrica, não a utilize para carregar.

Dados técnicos do carregador

Tensão de entrada: AC220V ± 10% Tensão de saída: 24V / DC Corrente de saída: 3A

9.3 UTILIZAÇÃO DO CARREGADOR

Para carregar a bateria, ligar o carregador à fonte de alimentação e à ficha da caixa de bateria. Siga as instruções abaixo para completar o processo de carregamento.

Passo 1: Certificar-se de que a ranhura do carregador não está bloqueada.

Passo 2: Certificar-se de que a cadeira de rodas elétrica está desligada.

Passo 3: desligar as fichas que ligam a caixa de bateria e o controlador.

Passo 4: ligar a ficha de saída do carregador à tomada da caixa de bateria.

Passo 5: ligar a ficha principal do carregador à fonte de alimentação e a luz vermelha acender-se-á. A carga completa demora 8 a 10 horas, não sobrecarregar por mais de 24 horas.

Passo 6: para evitar uma curta duração da bateria, carregar a bateria pelo menos uma vez por mês quando a cadeira não estiver a ser utilizada.

9.4 UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE A BATERIA

Uma operação incorrecta para substituir a bateria pode causar perigo de explosão. Apenas o mesmo tipo de bateria recomendado é adequado para substituição. Certificar-se de que os postes da bateria estão correctos.

Pontos-chave para prolongar a duração da bateria: Carregue frequentemente para manter a bateria cheia. É melhor carregar completamente a bateria se a cadeira de rodas não estiver a ser utilizada. Se não a utilizar durante muito tempo, é melhor carregar duas vezes por mês.



CUIDADO

Não parar de carregar até que o processo de carregamento esteja completo. A utilização repetida da bateria se não estiver completamente carregada encurtará a sua vida útil, pelo que a bateria deverá estar completamente carregada o mais possível.

Quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador de energia acenderá a verde. Não parar de carregar antes de estar totalmente carregado.

Após o carregamento estar completo, desligue a alimentação, caso contrário a bateria descarrega-se lentamente. Não cobrar por mais de 24 horas. A sobrecarga da bateria pode ser perigosa.

Os utilizadores devem seguir as seguintes regras para evitar riscos durante o carregamento:

A cadeira de rodas elétrica inclui o carregador. Deve ser bem ventilada durante o carregamento. Não exponha a cadeira de rodas à luz solar e a um ambiente húmido.

A gama de temperaturas do ambiente de carregamento é de 10 a 50. Se estiver fora da gama de temperaturas ambiente, a bateria não pode funcionar bem e pode ser facilmente danificada.

É normal que o ventilador faça um som durante o carregamento. É para o arrefecer.

Evitar que qualquer líquido entre em contacto com o carregador durante o carregamento. Não colocar o carregador em artigos inflamáveis, tais como: combustível, apoio para os pés ou almofada do assento.

Manter afastado das chamas abertas ao carregar a bateria. As chamas podem causar fogo ou explosão da bateria.

A carga produz hidrogénio, não fume enquanto carrega. Não desligue a fonte de alimentação quando a tomada ou as suas mãos estiverem molhadas, pois isto pode causar um choque elétrico.

10. SISTEMA DE DIAGNÓSTICO

Quando as luzes indicadoras LED piscam, significa que a cadeira de rodas apresenta anomalias. Podem ocorrer anomalias nas seguintes partes: motores, travões, bateria, ligações de cabos, etc.

Através da consulta de informação interna do produto, o sinal de diagnóstico pode detectar a propriedade da condição anormal. A situação anormal pode ser detectada sem outras ferramentas de serviço.

INDICAÇÃO DO SINAL ÁUDIO

| Descrição da luz LED | Significado da luz LED | Explicação e solução |
|--|---|---|
| Todas as luzes LED estão apagadas sem som. | A energia está desligada, cadeira de rodas em modo de espera ou em modo de inactividade. Alimentação eléctrica defeituosa. O fusível é troçado ou queimado. | |
| Todas as luzes LED estão acesas. | A energia está ligada e o auto-diagnóstico é passado. A cadeira de rodas eléctrica pode funcionar bem. | Menos luzes LED acesas, menos bateria restante. |
| A luz LED vermelha mais à esquerda está acesa. | A energia da bateria é extremamente inadequada. | Para carregamento imediato, ou a bateria funciona mal e não pode ser carregada. |
| Dois bipes curtos com cinco luzes indicadoras a piscar duas vezes. | O motor do lado esquerdo não funciona correctamente. | O motor esquerdo não está ligado correctamente ou está completamente desligado. |
| Quatro bipes curtos com cinco luzes indicadoras a piscar quatro vezes. | O motor do lado direito não funciona correctamente. | O motor do lado direito está incorretamente ligado ou o cabo está desligado. |
| Seis bipes curtos com cinco luzes indicadoras a piscar seis vezes. | Controlador está em estado de protecção de sobrecorrente | Verificar os travões e verificar se o mecanismo de accionamento do motor está encravado. Verificar a corrente por amperímetro, se não for corrente excessiva, o controlador pode não estar a funcionar correctamente. |
| Sete bipes curtos com cinco luzes indicadoras piscam sete vezes. | O joystick não funciona correctamente | O joystick não reiniciará ou o conector não se soltará. |
| Oito bipes curtos com cinco luzes indicadoras a piscar oito vezes. | O controlador não está a funcionar correctamente. | Consulte o seu concessionário para manutenção. |

11. CONTROLADOR

11.1 PAINEL DE CONTROLO



11.2 UTILIZAÇÃO DO CONTROLADOR

1. Interruptor de alimentação⁽¹⁾

Se premir este botão, as luzes indicadoras de carga da bateria acenderão da esquerda para a direita. Volte a premir, todas as luzes LED estão apagadas.

Em caso de emergência, pode desligar a corrente diretamente pressionando o botão de corrente.

2. Modo de sono

Se o joystick não funcionar durante mais de 20 minutos, a alimentação é automaticamente desligada e o sistema entra em modo de repouso, o sistema será activado a partir do modo de repouso premindo o botão de alimentação.

3. Ajuste de velocidade⁽²⁾

Dependendo dos hábitos e circunstâncias do utilizador, a velocidade de condução da cadeira de rodas é ajustável.

Ajustar a velocidade pressionando o botão de diminuir ou de aumentar.

A velocidade é dividida em cinco secções, com um intervalo de 20%, 40%, 60%, 80%, 100% da velocidade máxima.

Primeira velocidade: 20% da velocidade máxima.

Quinta velocidade: 100% da velocidade máxima.

4. Botão da buzina⁽³⁾

Prima o botão da buzina, a buzina soará até soltar o botão.

5. Indicador de bateria⁽⁴⁾

Depois de ligar a corrente, o contador de energia da bateria está a funcionar. O indicador de potência da bateria também mostra a capacidade restante da bateria.

Como se mostra na imagem, a bateria está cheia. Quando apenas a luz LED vermelha ou amarela está acesa, a bateria precisa de ser carregada. E para a condução de longa distância, a bateria deve estar totalmente carregada. Se apenas a luz vermelha LED estiver acesa, a energia da bateria é extremamente inadequada, os utilizadores devem carregar a bateria o mais cedo possível.

6. Utilização de joystick⁽⁵⁾

A direcção do movimento da cadeira de rodas é controlada por um joystick. A extensão móvel do joystick também controla a velocidade do movimento.

Ligar ou desligar a corrente quando o joystick estiver na posição do meio. Caso contrário, o controlador dará um sinal de funcionamento incorreto.

Se soltar o joystick no meio, este erro irá parar. Se o erro continuar, talvez esta peça seja uma avaria, não a utilize e contacte o seu concessionário para manutenção.

12. MANUTENÇÃO

A manutenção da cadeira de rodas inclui cadeira de rodas limpa, verificar a roda e a bateria, e carregar a bateria. Para manutenção adicional, contacte o seu revendedor. A nossa sugestão é verificar a cadeira de rodas a cada meio ano, serviço anual.

12.1 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BATERIA

Cadeira de rodas limpa: Por favor limpar regularmente a cadeira de rodas. Limpar as partes que frequentemente tocam o corpo do utilizador (tais como a almofada, o apoio de braços, o controlador) com um pano limpo e ligeiramente húmido. Não utilizar solventes orgânicos para a limpeza. Se for um utilizador paciente, a cadeira de rodas deve ser limpa uma vez por semana. Se a cadeira de rodas for utilizada por uma vítima infecciosa, deve ser limpa e desinfetada por desinfetantes.

Rodas: Verificar regularmente a pressão de ar e o desgaste dos pneus. Quando a profundidade do piso do pneu for reduzida para 1 mm, substituir o novo pneu.

Bateria: Para assegurar que a bateria é carregada com frequência. Para prolongar a duração da bateria, recomendamos vivamente que os utilizadores não carreguem até que a bateria esteja completamente esgotada.

12.2 MAU FUNCIONAMENTO E CONTROLO DA CADEIRA DE RODAS

Quando ocorrem avarias durante o funcionamento da cadeira de rodas, desligue a alimentação elétrica antes de verificar.

Sintoma: perda total de energia e todas as luzes LED no painel de controlo estão desligadas.

Etapa de verificação:

Passo 1: para verificar se a ficha do controlador está solta.

Passo 2: para verificar se a ligação da ficha do controlador e da caixa de bateria está solta. Volte a inserir o conector (segure a ficha quando a remover. Não puxar o cabo para evitar danos desnecessários na linha do cabo). Após a verificação acima, se a cadeira de rodas ainda não conseguir restaurar a energia, ou se os utilizadores tiverem quaisquer perguntas sobre a verificação acima, contacte o seu revendedor.



O controlador tem um sistema de diagnóstico para monitorizar o controlador e o motor. Qualquer mau funcionamento destas peças é indicado pelo controlador. Para mais detalhes, consultar o capítulo de indicação de sinal áudio.

12.3 VERIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO

Segue-se uma lista de verificação. A cadeira de rodas elétrica deve ser verificada de acordo com a nossa sugestão. Ao entrar ou sair da cadeira de rodas, uma auto-verificação é realizada automaticamente. Para mais atenção, em particular, listamos estes itens de auto-verificação na área A.

| | |
|--------|--|
| Área A | Antes de usar, verificar se as seguintes partes estão correctas: 1. encosto / 2. apoios de braços / 3. posição do controlador / 4. apoio para os pés 5. Bateria / 6. alavanca da embraiagem - ajuste para conversão entre o modo manual e elétrico. |
| Área B | Verificar mensalmente as seguintes peças, para evitar que as peças originais se soltem: Parafusos / 2. travões / 3. alavanca de embraiagem - ajuste para conversão entre modo manual e eléctrico / 4. rodas dianteiras e traseiras e profundidade do piso / 5. controlador e "conectores" do carregador |
| Área C | Por razões de segurança, a manutenção geral é exigida de seis em seis meses. |

12.4 CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Durante o transporte e armazenamento, a cadeira de rodas elétrica deve ser posicionada correctamente como indicado no rótulo.

- Evitar o transporte de humidade e luz solar e longe de fontes de calor.
- Em caso de danos nas partes elétricas devido à humidade, evitar armazenar a cadeira de rodas à chuva, ao ar livre e à humidade.
- Condições de armazenamento:
- Temperatura ambiente -40°C ~ + 55°C
- Humidade relativa ≤80%;
- Pressão de ar 86kPa ~ 106kPa.



A cadeira de rodas não é submetida a testes de colisão e, portanto, não pode ser utilizada para transporte em veículos adaptados.

13. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS. CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA DOBRÁVEL KITTOS CITY

O **Kittos City** é uma cadeira ideal para viagens e uso urbano, dobrável em apenas 5 segundos e tem rodas patenteadas para facilitar o transporte quando dobrado. Tem novas melhorias tais como um novo sistema de extracção de bateria melhorado, um novo sistema para fácil ligação e desconexão do motor, e um novo sistema para fácil ligação e desconexão do motor.



Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Cadeira de rodas elétrica dobrável Kittos City

V6 · 10/11/2022